

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目につきまして、現行試薬の販売中止に伴い同一メーカーが販売する測定範囲の広範化が計られた改良品に変更致します。つきましては、変更内容について、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- 抗RNP抗体定量 : 項目コード 4689

変更期日

平成27年6月1日（月）受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社／ 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社／ 仙台市宮城野区扇町 1-1-6 TEL 022-236-9345
中部支社／ 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社／ 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社／ 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター

保健科学東日本

日本ノーバメディカル研究所

いかがく

組織科学研究所

ケーアイエー細胞病理研究所

カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所

日本厚生団衛生科学研究所

湘南医化学検査センター

小田原衛検


相模医研

東部メディカルセンター

平成27年6月1日(月)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
4689	抗RNP抗体定量	報告上限	550.0 以上 (U/mL)	300.0 以上 (U/mL)	同一メーカーの販売する改良品への変更のため。尚、基準値等の変更はありません。	62

▼ 現試薬と新試薬の比較

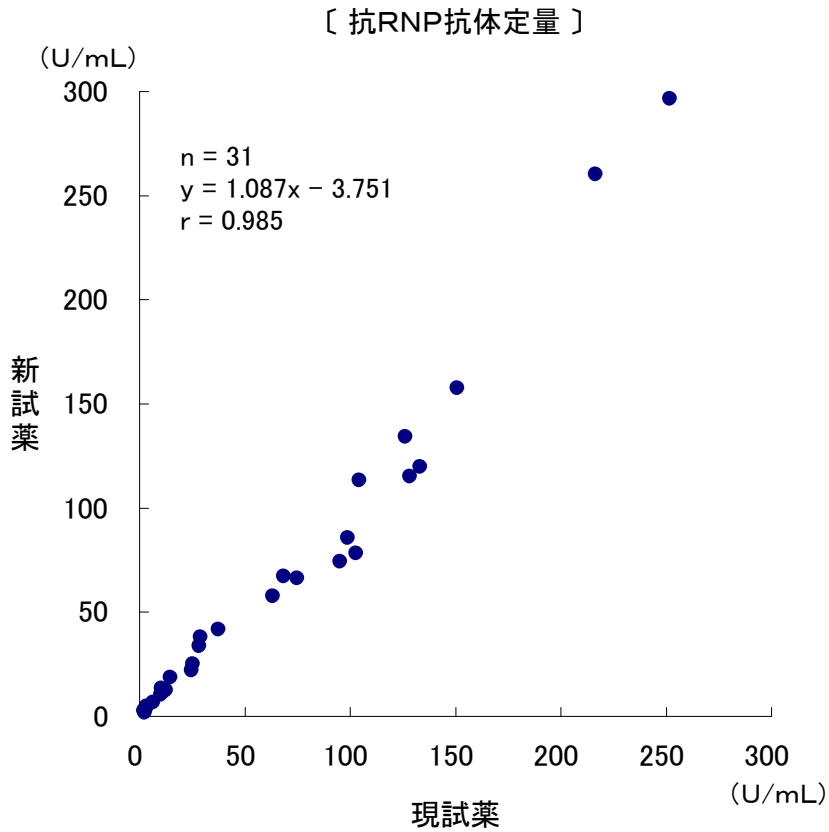

		現試薬	
		(+)	(-)
新試薬	(+)	23	0
	(-)	0	8

全体一致率: 100%

(自社検討資料)