

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、下記の検査項目につきまして、試薬製造元より、特異的IgEブタクサの試薬製造方法の改良に伴う改良品への変更の連絡がありましたのでご案内申し上げます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- IgEシングルアレルゲン ブタクサ :項目コード 4136

変更期日

平成29年10月2日(月)受託分より変更

変更理由

ブタクサ花粉抗原の抽出工程の改良に伴い反応性の向上が認められました。この結果、測定値が従来に比べ高値傾向となります。報告範囲、判定基準等に関しまして変更はございません。



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161


▼ 現試薬と新試薬(改良品)の比較

[4136:IgEシングルアレルゲン ブタクサ]


(n = 95)

新 試 薬	6						
	5				1	1	
	4			1	4	1	
	3		1	3	8		
	2	1	8	16			
	1	6	1				
	0	43					
	クラス	0	1	2	3	4	5
		現 試 薬					

<全体>

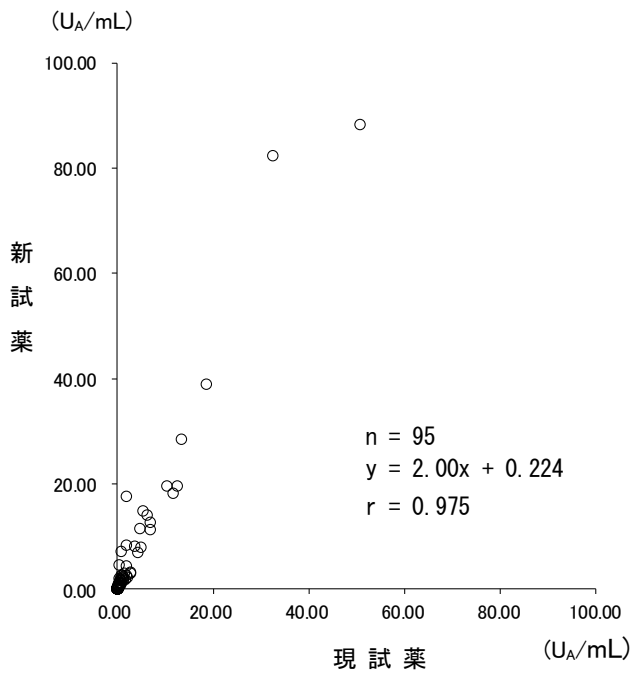

<低値域>

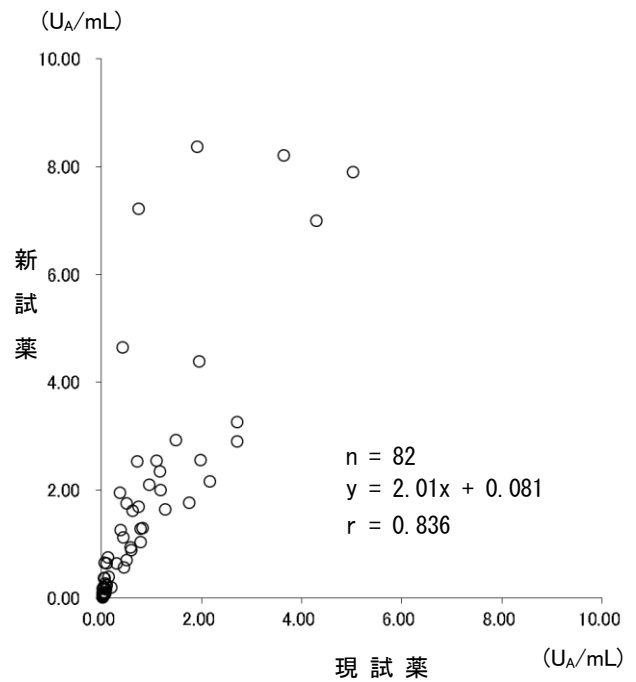

(社内検討資料)