

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、測定試薬の販売メーカーより「特異性を改善した改良試薬に変更する」旨の連絡がありました。つきましては、当社と致しましても改良試薬による検査に変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- 単純ヘルペス（HSV） I g M抗体 項目コード：7241
- 麻疹 I g M抗体 項目コード：7142

変更期日

平成26年1月4日（土）受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 **保健科学研究所**

本社／ 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社／ 仙台市宮城野区扇町 1-3-5 TEL 022-236-9345
中部支社／ 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社／ 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社／ 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター

保健科学東日本

日本ノーバメディカル研究所

いかがく

組織科学研究所

ケーアイエー細胞病理研究所

カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所

日本厚生団衛生科学研究所

湘南医化学検査センター

小田原衛検

相模医研


東部メディカルセンター

平成26年1月4日(土)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
7241	単純ヘルペス(HSV) IgM抗体	測定試薬	詳細については、下記をご参照願います。		特異性を改善した試薬への変更。	83
7142	麻疹 IgM抗体					

▼ 現試薬と新試薬の比較

[単純ヘルペス(HSV)IgM抗体]

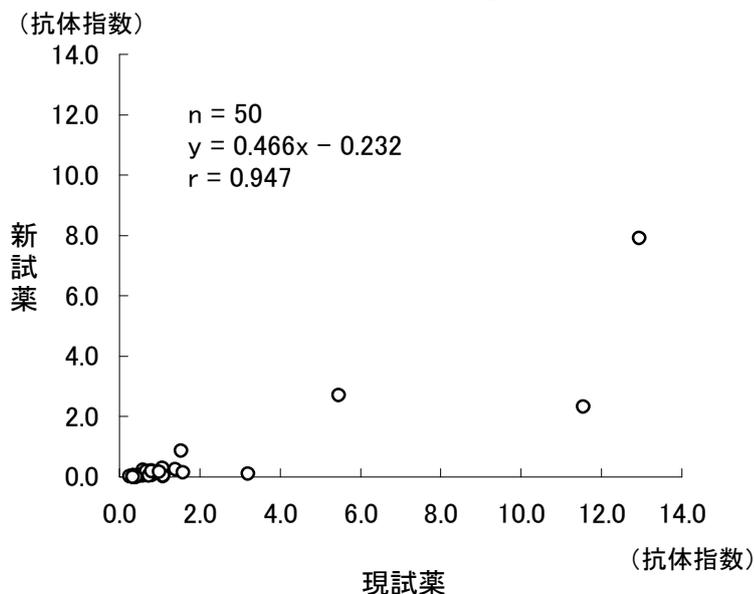


		現試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	4	0	0	4
	(±)	1	0	0	1
	(-)	3	9	33	45
合計		8	9	33	50

一致率: 74%

判定基準
(+) 1.21以上
(±) 0.80~1.20
(-) 0.80未満

[麻疹IgM抗体]

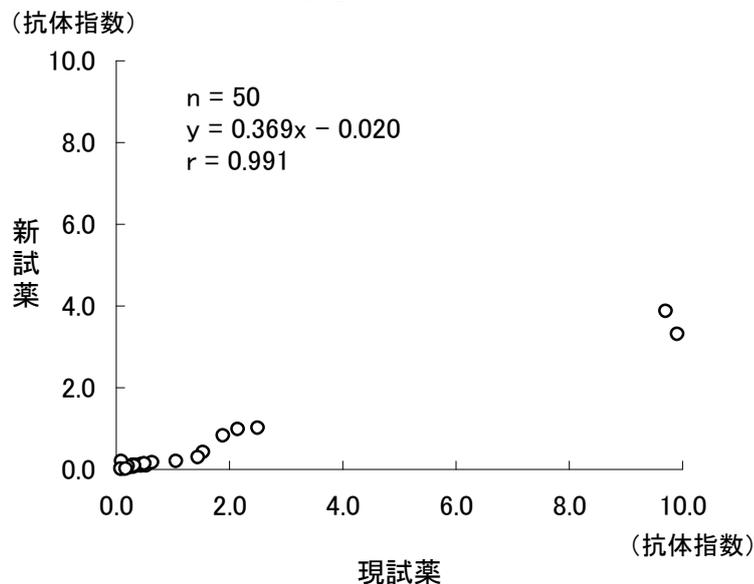

		現試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	3	0	0	3
	(±)	2	0	0	2
	(-)	2	1	42	45
合計		7	1	42	50

一致率: 90%

判定基準
(+) 1.21以上
(±) 0.80~1.20
(-) 0.80未満

(社内検討資料)

測定試薬の非特異反応を軽減し、特異性を改善した試薬に変更させていただきます。
この変更に伴う基準値などの検査要項の変更はございません。

▼ 参考文献

川名 尚, 他: 医学と薬学 69(3): 517~522, 2013. (単純ヘルペスウイルスIgM)
庵原 俊昭, 他: 医学と薬学 69(6): 969~975, 2013. (麻疹ウイルスIgM)