

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目につきまして、検査委託先より、現行試薬の販売中止に伴う試薬変更について連絡がありました。これに伴い、検査内容が一部変更されますのでご案内いたします。

先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

● 抗 J o - 1 抗体定量 : 項目コード 4 8 8 3

変更期日

平成 2 7 年 1 2 月 1 7 日 (木) 受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所


本社／横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社／仙台市宮城野区扇町 1-1-6 TEL 022-236-9345
中部支社／名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社／豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社／福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター 遠州予防医学研究所
保健科学東日本 日本厚生団衛生科学研究所
日本ノーバメディカル研究所 湘南医化学検査センター
いかがく小田原衛検
組織科学研究所 相模医研
ケーアイエー細胞病理研究所 東部メディカルセンター
カスタムメディカル研究所

平成27年12月17日（木）受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
4883	抗Jo-1抗体定量	検査方法	CLEIA法	EIA(ELISA)法	測定試薬変更に伴う検査内容の変更となります。尚、左記以外の変更はありません。	63
		基準値	10.0 未満 (U/mL)	10.0 以下 (U/mL)		
		報告上限	550 以上 (U/mL)	500 以上 (U/mL)		
		報告下限	1.0 未満 (U/mL)	7.0 以下 (U/mL)		
		備考	不活化（非働化）検体ではデータに影響を及ぼす場合がありますので避けてください。	（未記載）		

▼ 現法と新法の比較

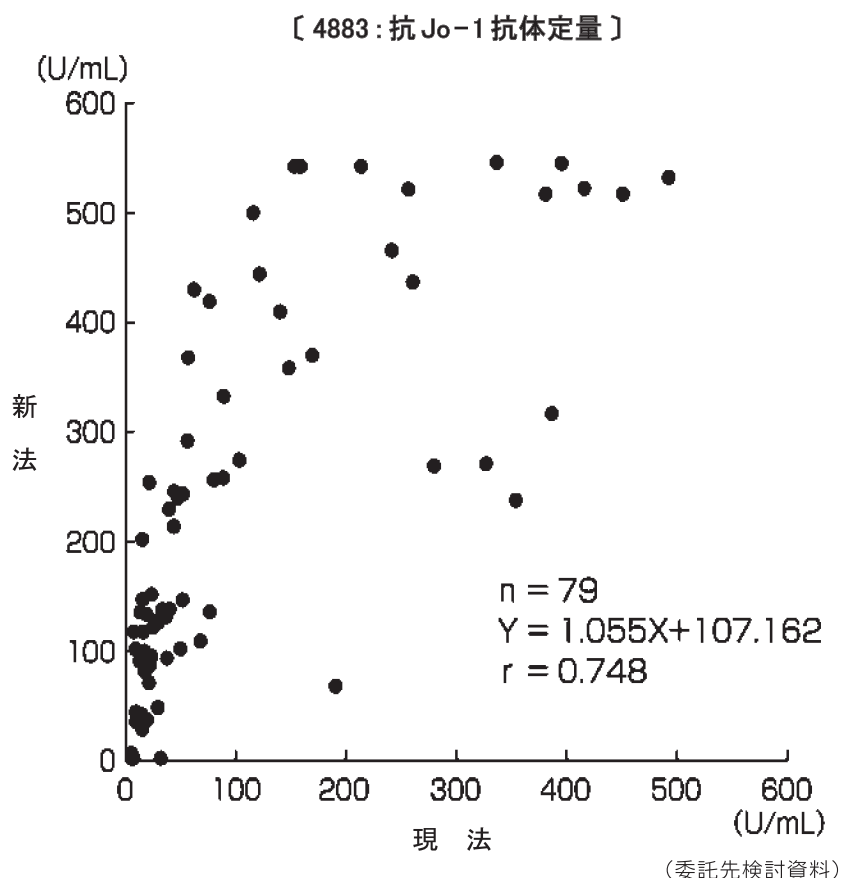

▼ 検査方法参考文献

松下 雅和, 他: 医学と薬学 70(1): 109~117, 2013.