

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、下記の検査項目につきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- KL-6 : 項目コード 1710
- アルドステロン/レニン活性比（PAC/PRA比） : 項目コード 5784
- レニン活性（PRA） : 項目コード 5025

変更期日

平成 28 年 2 月 1 日（月）受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社／横浜市保土ヶ谷区神戸町106 TEL 045-333-1661
仙台支社／仙台市宮城野区扇町1-1-6 TEL 022-236-9345
中部支社／名古屋市西区則武新町2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社／豊中市原田中1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社／福岡市博多区山王2-14-34 TEL 092-452-0851


新潟臨床検査センター 遠州予防医学研究所
保健科学東日本 日本厚生団衛生科学研究所
日本ノーバメディカル研究所 湘南医化学検査センター
いかがく小田原衛検
組織科学研究所 相模医研
ケーアイエー細胞病理研究所 東部メディカルセンター
カスタムメディカル研究所

平成28年2月1日（月）受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	検査案内書掲載ページ
1710	K L-6	所要日数	1～2日	2～5日	アッセイスケジュールの見直しに伴う変更です。	21
5784	アルドステロン/レニン活性比（PAC/PRA比）	検体必要量	血漿 0.6 mL 又は 血漿 0.3 mL 血清 0.3 mL （同時提出時）	血漿 1.2 mL 又は 血漿 0.9 mL 血清 0.3 mL （同時提出時）	レニン活性の現行試薬発売中止に伴う変更です。	32
		所要日数	3～5日	2～4日		
5025	レニン活性（PRA）	検体必要量	血漿 0.3 mL	血漿 0.9 mL		36
		基準値（単位）	臥位 0.3～2.9 立位 0.3～5.4 ng/mL/h	臥位 0.2～2.7 立位 0.2～3.9 ng/mL/h		
		所要日数	3～5日	2～4日		

▼ 現試薬と新試薬の比較

〔5025：レニン活性（PRA）〕

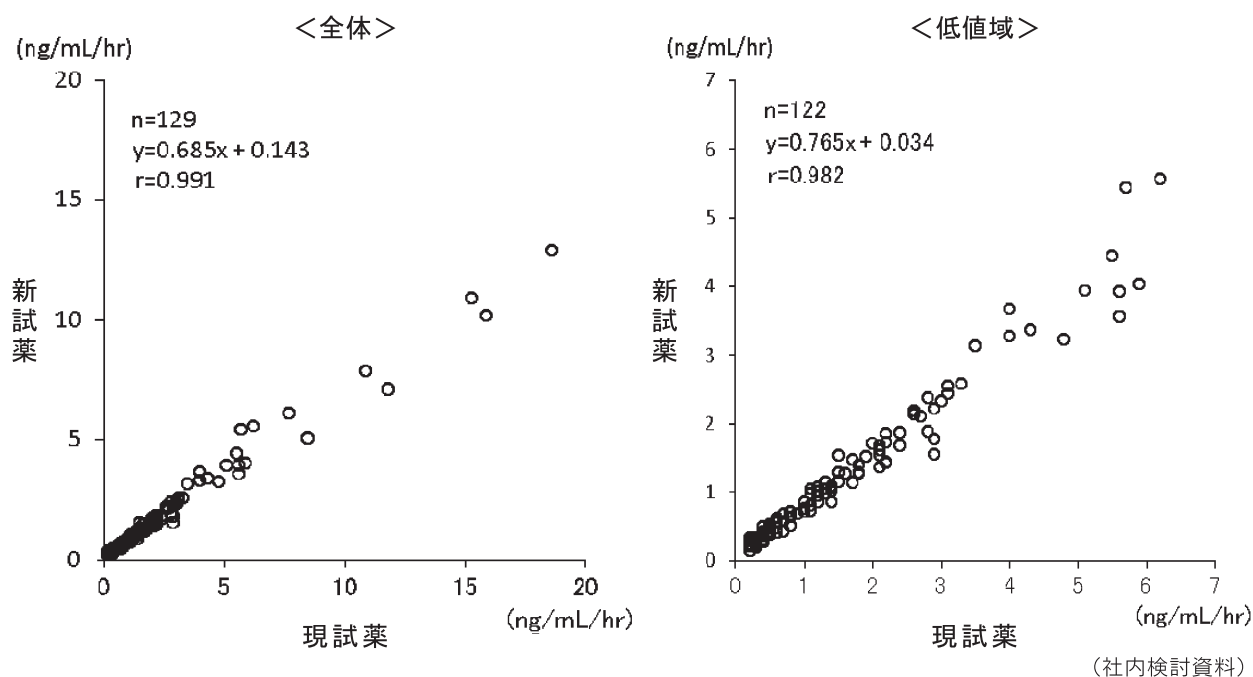

※レニン活性（PRA）において、新試薬は現試薬と比較し測定結果が低く出る傾向にあります。これはレニン活性の標準物質に国際標準品が無く、試薬毎の基準に則り値付けをしていることによります。

▼ 検査方法参考文献

廣井 直樹，他：医学と薬学 32（1）：81-86，1994。（レニン活性（PRA））