

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、下記の検査項目につきまして、試薬製造販売中止および試薬製造元より「試薬の仕様変更により、検査内容の一部が変更になる」旨の連絡がありました。つきましては、弊社におきましても検査内容を一部変更させて頂きたくご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- α_1 -マイクログロブリン《血清》 :項目コード 1193
- α_1 -マイクログロブリン《尿》 :項目コード 1194
- 抗DNA抗体定量 :項目コード 4075

変更期日

平成30年1月4日(木)受託分より変更

変更内容

※ 詳細につきましては、裏面の内容をご参照願います。




保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

平成30年1月4日(木)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載ページ
1193	α_1 -マイクログロブリン(α_1 -MG)《血清》	基準値 (単位)	12.7~27.3 mg/L	11.0~24.0 mg/L	測定試薬販売中止に伴う検査内容の変更です。 測定原理に変更はございません。	2
		報告上限 (単位)	1800 以上 mg/L	500 以上 mg/L		
		報告下限 (単位)	1.1 以下 mg/L	0.5 以下 mg/L		
1194	α_1 -マイクログロブリン(α_1 -MG)《尿》	報告上限 (単位)	600 以上 mg/L	2500 以上 mg/L		
		報告下限 (単位)	0.3 以下 mg/L	0.5 以下 mg/L		
4075	抗DNA抗体定量	報告上限 (単位)	200.0 以上 IU/mL	300.0 以上 IU/mL	試薬の仕様変更に伴い、報告上限が変更となります。基準値等に変更はありません。	64

▼ 現法と新法の比較

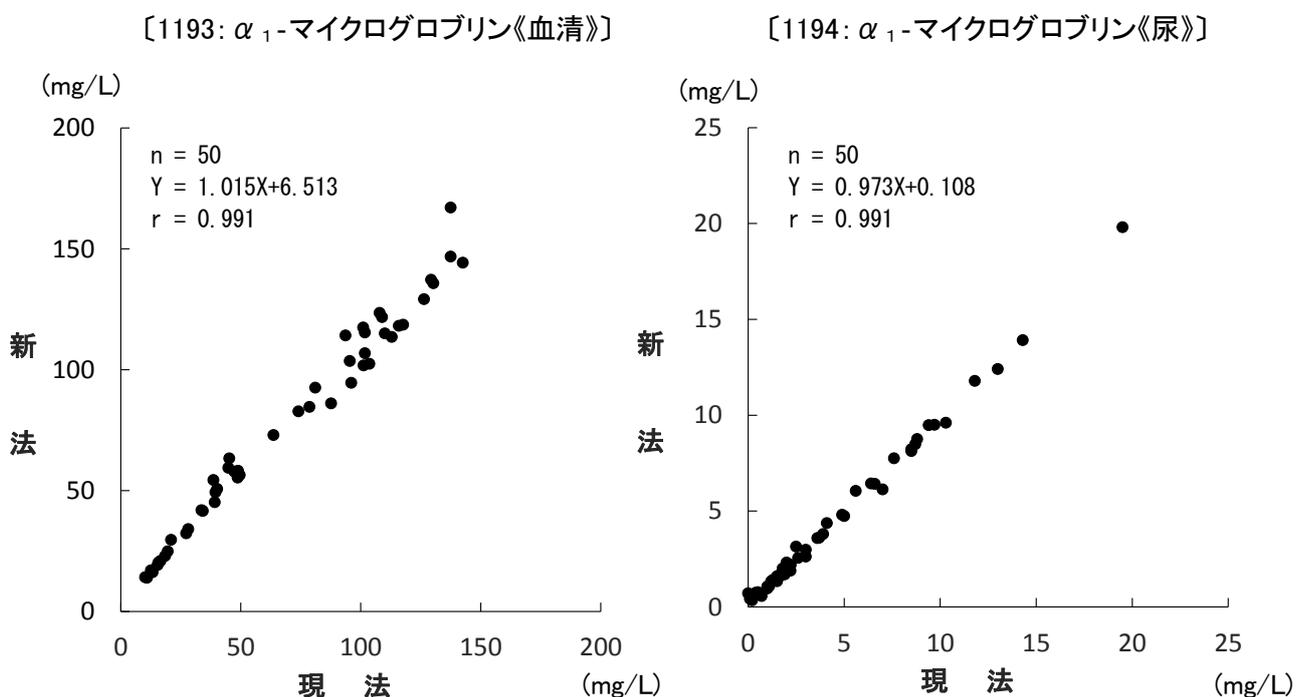

▼ 参考文献

徳山 昌司郎: 医学と薬学 39:835-844, 1998. (α_1 -マイクログロブリン)