

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、下記の検査項目におきまして、測定試薬メーカーより、当該試薬のキャリブレーター、コントロールの製造に使用する基準物質を WHO 1st International Reference Preparation 1977(Code W1042)から WHO 2nd International Reference Preparation 2008(Code 07/164)に変更する旨の連絡がありましたので、ご案内申し上げます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

● HBs抗体 :項目コード 4002

変更期日

平成30年2月1日(木)受託分より変更



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

平成30年2月1日(木)受託分より変更


項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載ページ
4002	HBs抗体	基準値 (単位)	変更ありません	10.0 未満(-) mIU/mL	※2	83
		報告下限	2.5 未満 ※1	10.0 未満		

※1 医療関係者のためのワクチンガイドラインでは、抗体価が10.0mIU/mL以上に上昇している場合は免疫獲得と考えてよいとされています。

※2 その他の検査要項に変更はございません。

▼ 現試薬と新試薬の比較

[4002:HBs抗体]

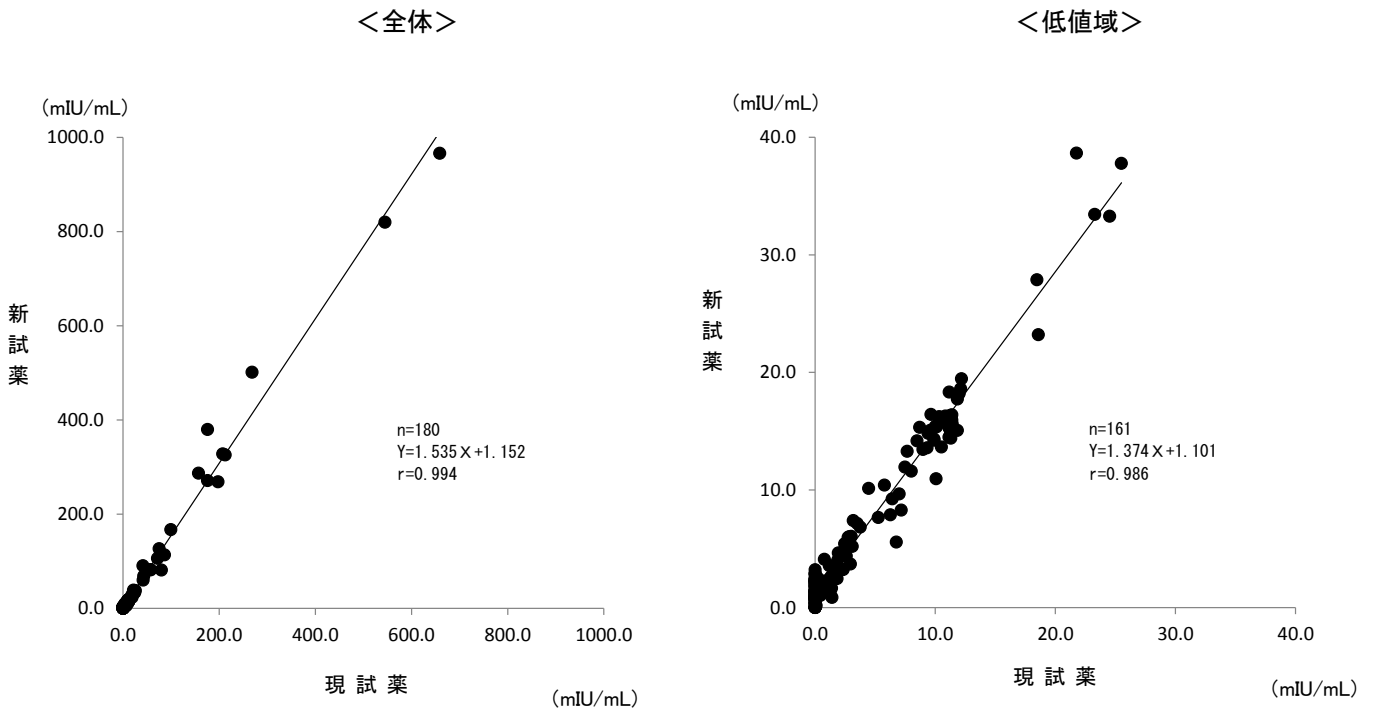

(社内検討データ)

▼ 参考文献

出口 松夫, 他:医学と薬学 74(9):1137, 2017