

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、下記の検査項目におきまして、測定試薬メーカーより測定試薬の製造販売を中止する旨の連絡がありましたので、測定試薬を変更させて頂きたくご案内申し上げます。

先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

● 血清補体価(CH₅₀)

項目コード: 4031

変更内容

※ 詳細につきましては、次ページの内容をご参照願います。

変更期日

平成30年4月2日(月)受託分より変更



保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161


平成30年4月2日(月)受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載ページ
4031	血清補体価(CH ₅₀)	検査方法	Mayer変法	TIA法	測定試薬販売中止に伴う検査内容の変更です。その他の検査要項に変更はございません。	69
		基準値単位	30.0 ~ 46.0 CH ₅₀ /mL	30 ~ 46 U/mL		
		報告上限(単位)	150.0 以上 CH ₅₀ /mL	125 以上 U/mL		
		報告下限(単位)	10.0 未満 CH ₅₀ /mL	7 以下 U/mL		
		報告桁数	小数点以下 第1位報告	整数		

※ 基準値は報告桁数に合わせた表記とさせていただきます。

▼ 現法と新法の比較

[4031:血清補体価(CH₅₀)]

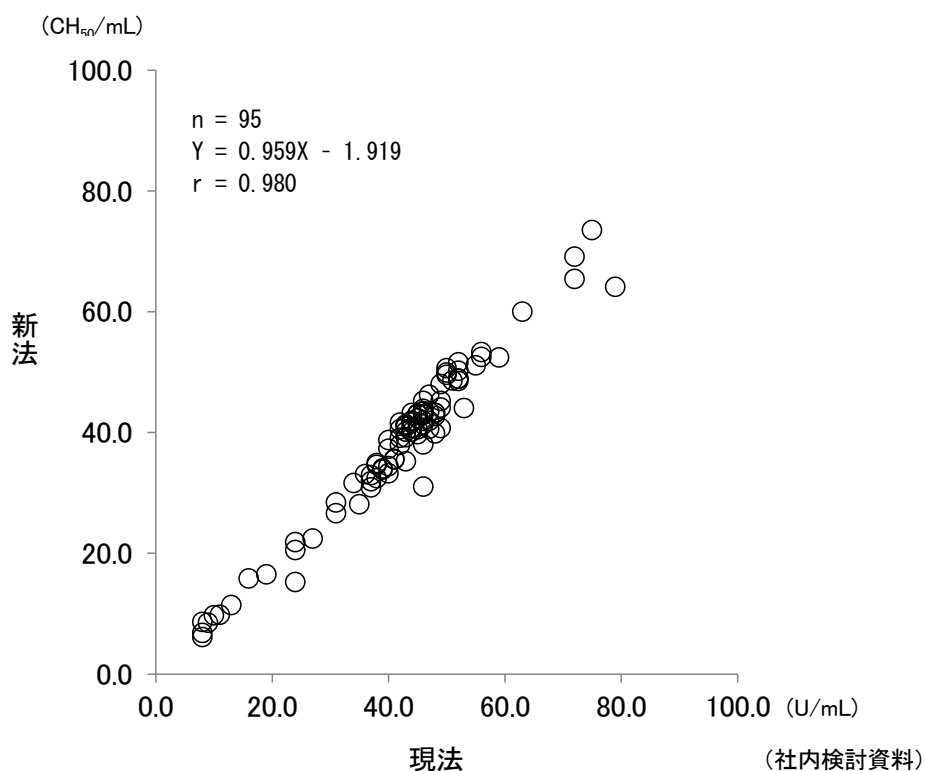

▼ 検査方法参考文献

西山有紀子 他:医学と薬学 64(6):915, 2010