

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、下記の検査項目におきまして、検査工程の見直しに伴い、測定機器を変更させて頂きたくご案内申し上げます。
先生方にはご不便をお掛け致しますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目

- プロカルシトニン定量(PCT)

項目コード: 5778

変更内容

※ 詳細につきましては、次ページの内容をご参照願います。

変更期日


平成30年10月1日(月)受託分より変更



保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考	総合検査案内掲載ページ
5778	プロカルシトニン定量(PCT)	測定機器	コバス 8000<e801>	モジュラーアナライティクス<E170>	測定機器の変更です。測定結果は、有効桁数3桁での報告となります。その他の事項に変更はございません。	56
		報告上限(単位)	100 以上 ng/mL	100.00 以上 ng/mL		
		報告下限(単位)	0.02 未満 ng/mL	0.02 以下 ng/mL		

▼ 現機器と新機器の比較

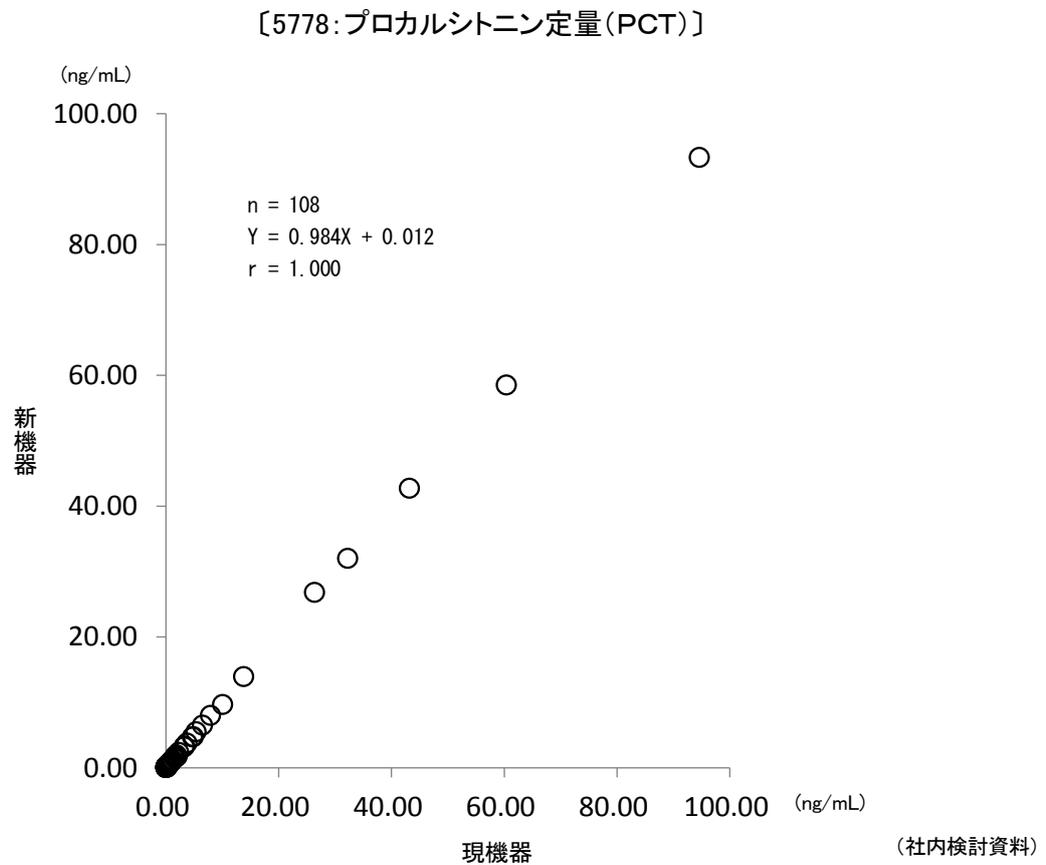

▼ 検査方法参考文献

古屋実、他:医学と薬学 74(5):607、2017