



検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

※ 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご参照願います。

変更期日

2021年 6月 1日(火)受託分より変更





保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL.045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL.048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL.075-933-6060
保健科学東京	〒160-0001 東京都新宿区片町3-3	TEL.03-3357-3611
保健科学新潟	〒950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-6-31	TEL.025-275-0161

変更項目および変更内容

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	変更理由	総合検査案内掲載頁
1962	シスタチンC	基準値	M 0.63 ~ 0.94 F 0.52 ~ 0.85 mg/L	M 0.63 ~ 0.95 F 0.56 ~ 0.87 mg/L	試薬製造中止に伴う試薬変更のため	6
		報告範囲	0.10 未満 } 16.20 以上 mg/L	0.04 未満 } 13.1 以上 mg/L		
5701	カルニチン	所要日数	1 ~ 2 日	4 ~ 6 日	定期的な見直しのため	19
		検査場所(略称)	保健科学 総合研究所	LSIメディエンス(*1)		
1710	KL-6	試薬変更のみの為、基準値等の変更はございません。			試薬製造中止に伴う試薬変更のため	21
5746	副甲状腺ホルモン Whole-PTH	基準値	8.3 ~ 38.7 pg/mL	7.2 ~ 39.1 pg/mL	試薬変更のため	27
		検査場所(略称)	保健科学 総合研究所	保健科学 第2ラボラトリー(*ア)		
5063	HANP (ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド)	基準値	43 以下 pg/mL	43.0 以下 pg/mL	試薬変更のため	38
		報告範囲	5 以下 } 2000 以上 pg/mL	5.0 以下 } 2000.0 以上 pg/mL		
4116	MMP-3 (マトリックスメタロプロ テイナーゼ-3)	試薬変更のみの為、基準値等の変更はございません。			試薬製造中止に伴う試薬変更のため	62

▼ 新試薬と旧試薬の比較

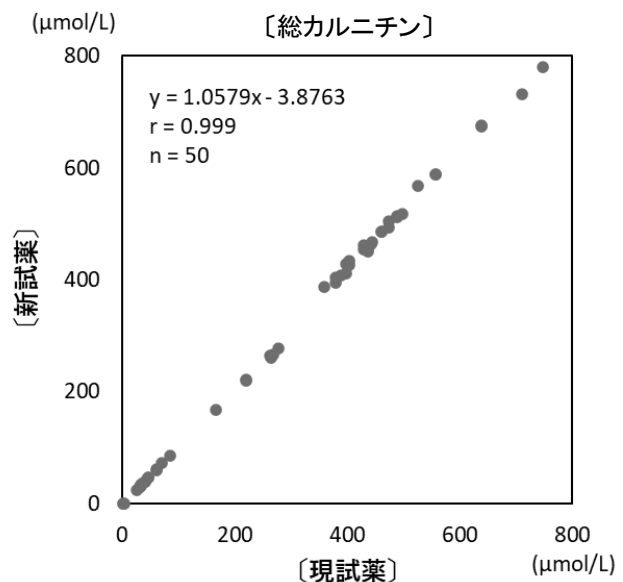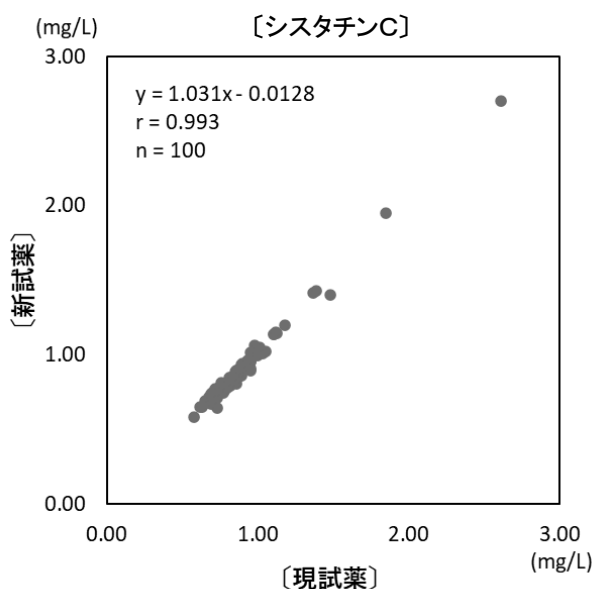

▼ 新試薬と旧試薬の比較

