

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、別掲の検査項目におきましては、定期的な見直しに伴い検査内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。
誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
敬具

記

変更項目および変更内容

※詳細につきましては、裏面内容をご参照願います。

変更期日

2022年10月1日（土）受託分より変更



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL. 045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL. 048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL. 075-933-6060

変更項目および変更内容


項目コード	検査項目	変更内容	新	現	変更理由	総合検査案内掲載頁	備考
5056	ビタミンB ₁₂	検査方法	CLEIA法	CLIA法		18	
		基準値	180～914 pg/mL	233～914 pg/mL			
		報告範囲	50未満 } 15000以上 pg/mL	45未満 } 20000以上 pg/mL			
		JLAC10	3G040-0000-023-052	3G040-0000-023-051			
5057	葉酸	検査方法	CLEIA法	CLIA法	試薬変更のため	18	
		基準値	3.1～19.9 ng/mL	3.6～12.9 ng/mL			
		報告範囲	1.0未満 } 124.0以上 ng/mL	0.4未満 } 120.0以上 ng/mL			
		JLAC10	3G105-0000-023-052	3G105-0000-023-051			
1709	SP-D (肺サーファクタント プロテイン-D)	検査場所	保健科学 総合研究所	保健科学 第2ラボラトリー (略号：*ア)		21	※1

※1 試薬変更のみの為、基準値等の変更はございません。


※新旧試薬の相関は次頁をご確認下さい。

▼新試薬と旧試薬の比較


〔ビタミンB₁₂〕

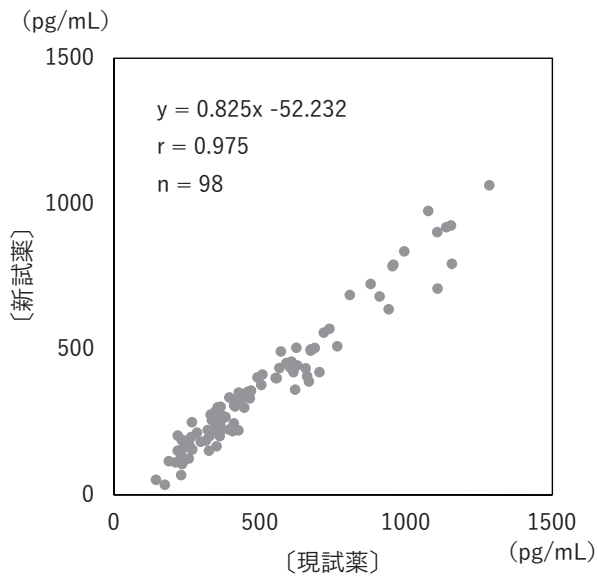

〔葉酸〕

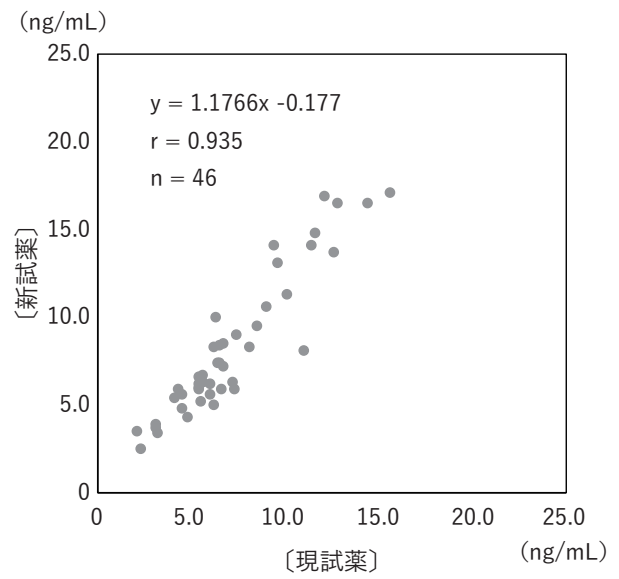

〔SP-D(肺サーファクタントプロテイン-D)〕

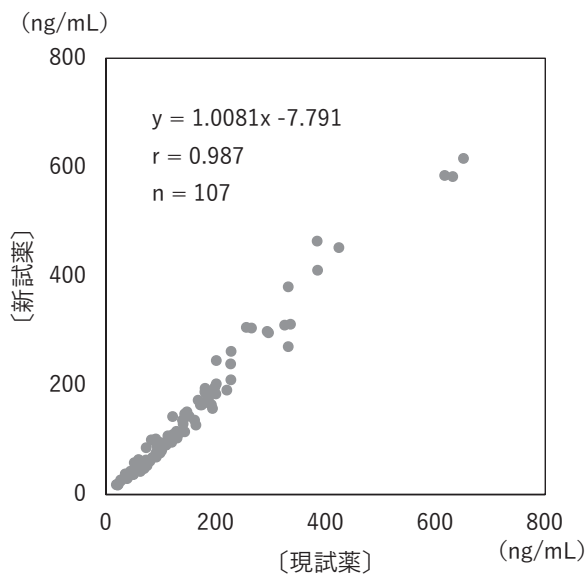

▼検査方法参考文献

- ・ 柿木孝志：全自動化学発光酵素免疫測定装置 UniCel DxI800 によるビタミンB₁₂、葉酸、フェリチンの検討.医学と薬学 58(2)：347-353,2007 〔ビタミンB₁₂〕 〔葉酸〕
- ・ 佐伯ひろみ：アクセスイムノアッセイシステムによる貧血関連検査 ビタミンB₁₂・葉酸.生体試料分析 29(3)：243-248, 2006. 〔ビタミンB₁₂〕 〔葉酸〕
- ・ 土居 耕介 他：医学と薬学：78-261,2021. 〔SP-D〕

